


# Användning av kontrollblod

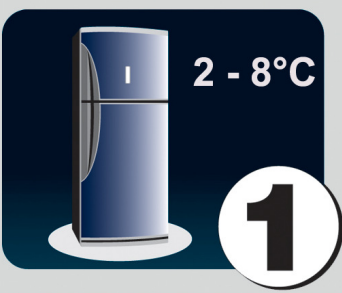

2 - 8°C  
**1**

**2**  Kontrollera volym, lot och utgångsdatum

**3**  Rumstemp. 10 min.

**4**  30 sek

**Manuell**

8 - 10 gånger



Ta av korken och kör kontrollen



Torka av rörkanten & korken innan korken sätts på



**Automatisk**



**Analysinstrument AL**



**5**

**6**

Kontrollera resultatet och rapportera det



**7**



RAL118BSV 06/10/2010